

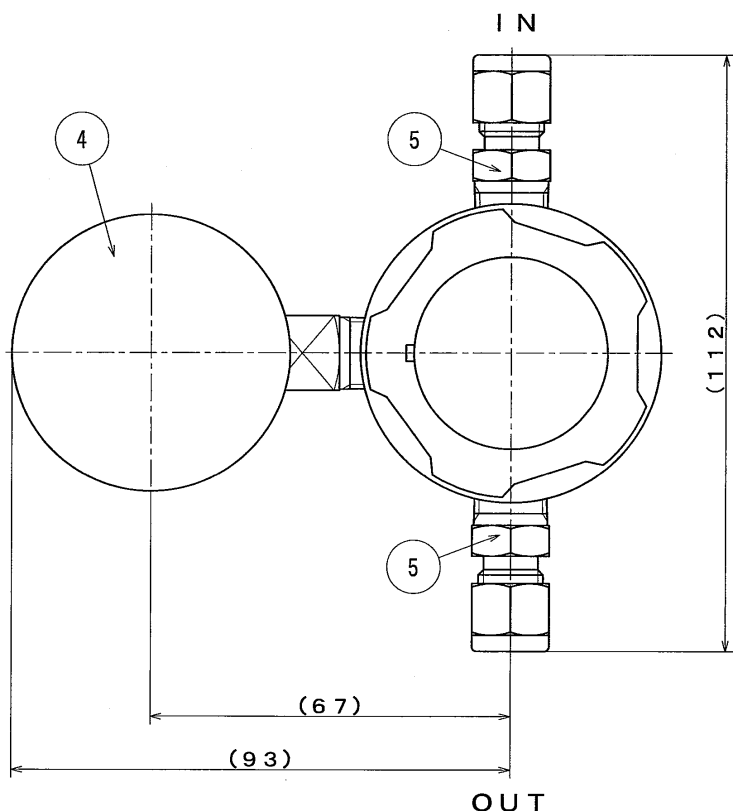


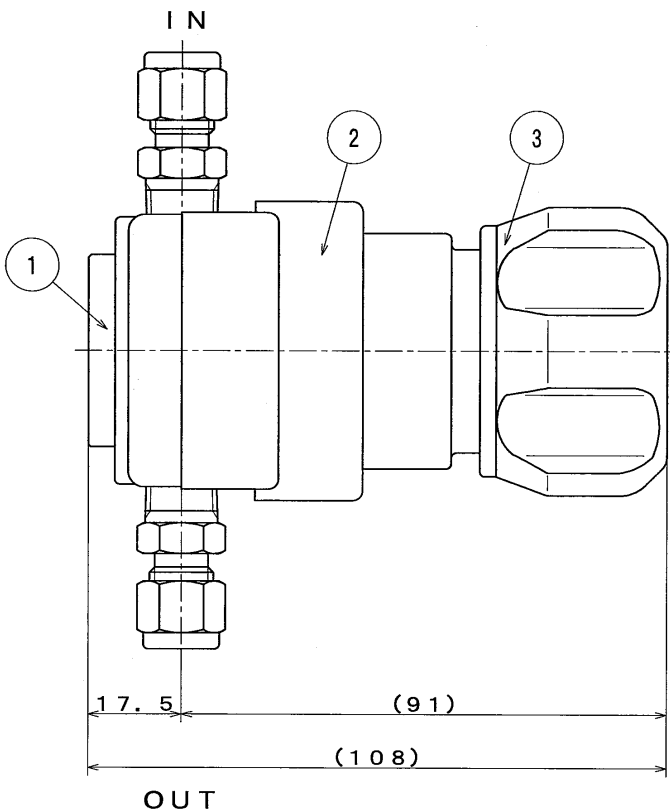

No	品名	材質
1	本体	SUS316L
2	キャップ	C3771/C3604
3	押ネジ	ABS樹脂 C3604
4	二次圧力計	SUS316L
5	出入口継手	ASTM A276 TYPE 316

※印部品のC3771、C3604については、カドミフリー材を使用。

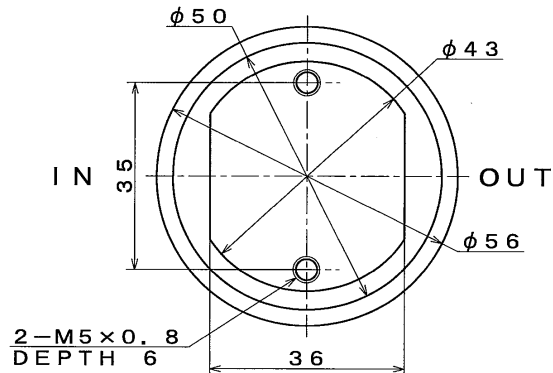

TORR-30-3S-A015-4SH4SH	5.0MPa	-0.1~1.5MPa	1/4" SWAGELOK
TORR-30-3S-A010-4SH4SH	5.0MPa	-0.1~1.0MPa	1/4" SWAGELOK
TORR-30-3S-A006-4SH4SH	5.0MPa	-0.1~0.6MPa	1/4" SWAGELOK
TORR-30-3S-A003-4SH4SH	5.0MPa	-0.1~0.3MPa	1/4" SWAGELOK
品名	一次側最高使用圧力	二次圧力計	出入口形状

日付 DATE	' 02. 12. 27	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN	品名 TITLE
尺度 SCALE	1/1	部長 08.4.25 小山	チーフ 08.4.25 三吉	リーダー 08.4.25 小島	TORR-30sr
水 ' 08. 04. 25 松本 8111 訂正歴 ' 02. 12. 27 松本 日酸TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION					

分類 TYPE	3
図番 DWG. No.	BN80864 木
訂正 Rev.	△△△△△△△△